



На фірмовому бланку MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD.

Сертифікат якості

Ми, MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD, надаємо даний сертифікат якості продукції для підтвердження якості та безпеки матеріалу, що використовується під час виробництва грілок

Назва виробу	Грілка медична, 3 L (л)	LOT (партия)	20244002	Об'єм:	3000 ml (мл)
Кількість зразків	1020 шт.	Дата виробництва	2024.03.20	Термін придатності	2027.09.01
Матеріал	гума				
Тестовий стандарт	HG2011-1991				
з/п	Пункт контролю	Технічний стандарт		Результат вимірювання	Результати
1	Мінімальна товщина грілки	≥ 1.0 mm (мм)		1.7 mm (мм)	Пройшов
2	Ємність	3000 \pm 100 ml (мл)		2960-2980 ml (мл)	Пройшов
3	Вага	450 g (г) \pm 10 g (г)		455 g (г)	Пройшов
4	Зовнішній вигляд	Повинен відповідати кресленням та вимогам HG2011-91		Відповідає	Пройшов
5	Кінцевик	Повинен легко монтуватися у отвір грілки, пластик повинен бути достатньо міцним. Всі деталі повинні бути гладкими, без заусениць, тріщин, сколів, розривів		Відповідає	Пройшов
6	Витік повітря	Висота наповнення грілки стисненим повітрям у 8 разів більша, ніж коли грілка плоска. Витоку повітря не повинно бути.		Відповідає	Пройшов
7	Витік води	Заповнення грілки на 2/3 гарячою водою температурою 90°C, щільне закриття пробки та піддавання дії вантажу вагою 20 kg (кг) на 10 min (хв). Витоку води бути не повинно.		Відповідає	Пройшов
8	Інтенсивність розтягнення	≥ 14 mPa (МПа)		15 mPa (МПа)	Пройшов
9	Зусилля на розрив	$\geq 500\%$		540%	Пройшов
10	Випробування на старіння (гаряче повітря) 70°Cx72 h (год)	Інтенсивність розтягнення ≤ -25		-6%	Пройшов
		Зусилля на розрив ≤ -25		-4%	
11	Випробування на зношування (гаряча вода) 100°Cx72 h (год)	Інтенсивність розтягнення ≤ -50		-5%	Пройшов
		Зусилля на розрив ≤ -50		-6%	

Висновок: дана партія продукції пройшла випробування

Ми підтверджуємо, що матеріал, застосований під час виробництва, є безпечний та не наносить ніякої шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Контроль: Tong Qing

Перевірів: Zhang Tianlu

Печать

Уповноважений представник України:


ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»

Україна, 61050 м. Харків

вул. Франківська, буд.14

тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua

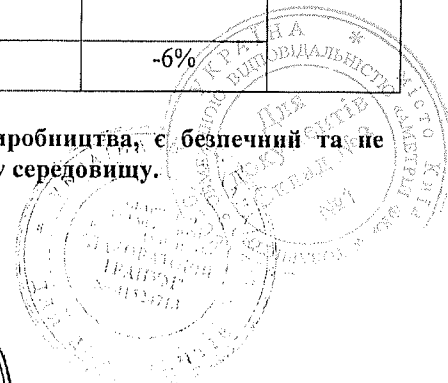

Зеленчук
22.11.2024