



Сертифікат якості № 1004

**КЛЕЙ МЕДИЦИННИЙ БФ-6,  
 по 15 г у тубах**

Номер партії 7-2024  
 Кількість продукції в партії 46,285 т. шт.

Дата виробництва 08.2024 р.

Випробування проведено згідно ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Прозора або злегка каламутна рідина від світло-жовтого до червоножовтого кольору	Прозора рідина світло-жовтого кольору
2.	Ідентифікація	1. До 1 г клею додають 4 мл ефіру. У результаті реакції повинні з'явитися білі пластівці (смола), які випадають в осад. 2. До 2,5 г клею, додають 50 мл води, струшують протитом 5 хв, рідку частину переганяють. До 0,5 мл відгону додають 6 мл розчину натрію титрогену розведеного та 2 мл 0,1 М розчину йоду. Відчувається характерний запах йодоформу 1. поступово утворюється жовтий осад йодоформу 3. До 2 мл відгону додають 0,5 мл кислоти оттової безводної 1 л мл кислоти оцтової 1 нагрівають на плиті до кипіння. Відчувається характерний запах етилового ефіру кислоти оттової	Відповідає
3.	Кількість клею	Туба повинна містити 15 ± 0,3 г клею	Відповідає 15,0 г
4.	Функціональне призначення	Клей повинен при нанесенні тонким шаром на суху шкіру протитом 2 хвилини утворювати товсту еластичну плівку, яка міцно утримується на поверхні шкіри	Відповідає
5.	Сухий залишок	Від 15,0 до 19,0 %	Відповідає 17,1 %
6.	Мікробіологічна контамінація: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТМАС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТММС) - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не більше 10 <sup>3</sup> КУО/г Не більше 10 КУО/г Не допускається наявність в 1 г Не допускається наявність в 1 г	Менше 100 КУО/г Менше 10 КУО/г Відповідає Відповідає
7.	Пакування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3	Відповідає
8.	Маркування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3; ДСТУ EN 980:2007	Відповідає
9.	Гарантійний термін зберігання	4 роки	Відповідає 2028-08
10.	Зберігання	При температурі не більше + 25 °С	Відповідає


Висновок: Партія 7-2024 відповідає вимогам ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007

Дата проведення сертифікату 08.08.2024 р.

КОНТРОЛЬ  
 НАД ЯКОСТЮ  
 ПРОДУКЦІЇ

*Handwritten signature*  
 Підпис

Шепельчук Є.В.  
 ДІЛ ПР

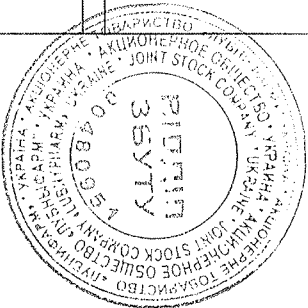

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ  
 ДУДНОВАЖЕНА ОСОБА  
 АНДРЕЙ М.Г. 08.08.2024

Результат перевірки відповідає

*Handwritten mark*