

КОпія

Додаток № 1

до Свідоцтва

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 9855/2010 від 18.10.2010

Пов'язки атравматичні, стерильні

виробництва PAUL HARTMANN AG (Germany), IVF HARTMANN AG (Switzerland)


№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
1.	Grassolind® neutral 5 x 5 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Grassolind® neutral 5 x 5 cm
2.	Grassolind® neutral 7,5 x 10 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Grassolind® neutral 7,5 x 5 cm
3.	Grassolind® neutral 10 x 20 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Grassolind® neutral 10 x 20 cm
4.	Grassolind® neutral 17 x 24 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Grassolind® neutral 17 x 24 cm
5.	Atrauman® 5 x 5 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Atrauman® 5 x 5 cm
6.	Atrauman® 7,5 x 10 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Atrauman® 7,5 x 10 cm
7.	Atrauman® 10 x 20 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Atrauman® 10 x 20 cm
8.	Atrauman® Ag 5 x 5 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Atrauman® Ag 5 x 5 cm
9.	Atrauman® Ag 7,5 x 10 cm	Пов'язки атравматичні з нетканого матеріалу, стерильні Atrauman® Ag 7,5 x 10 cm
10.	Atrauman® Ag 10 x 20 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Atrauman® Ag 10 x 20 cm
11.	Branolind® 7,5 x 10 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Branolind® 7,5 x 10 cm
12.	Branolind® 10 x 20 cm	Пов'язка атравматична з нетканого матеріалу, стерильна Branolind® 10 x 20 cm
13.	TenderWet® active cavity d 4 cm	Пов'язка комбінована сорбційна стерильна TenderWet® active cavity d 4 cm;
14.	TenderWet® active cavity d 5,5 cm	Пов'язка комбінована сорбційна стерильна TenderWet® active cavity d 5,5 cm
15.	TenderWet® active cavity 4 x 7 cm	Пов'язка комбінована сорбційна стерильна TenderWet® active cavity 4 x 7 cm
16.	TenderWet® active cavity 7,5 x 7,5 cm	Пов'язка комбінована сорбційна стерильна TenderWet® active cavity 7,5 x 7,5 cm;



Заступник Голови

МП

DI

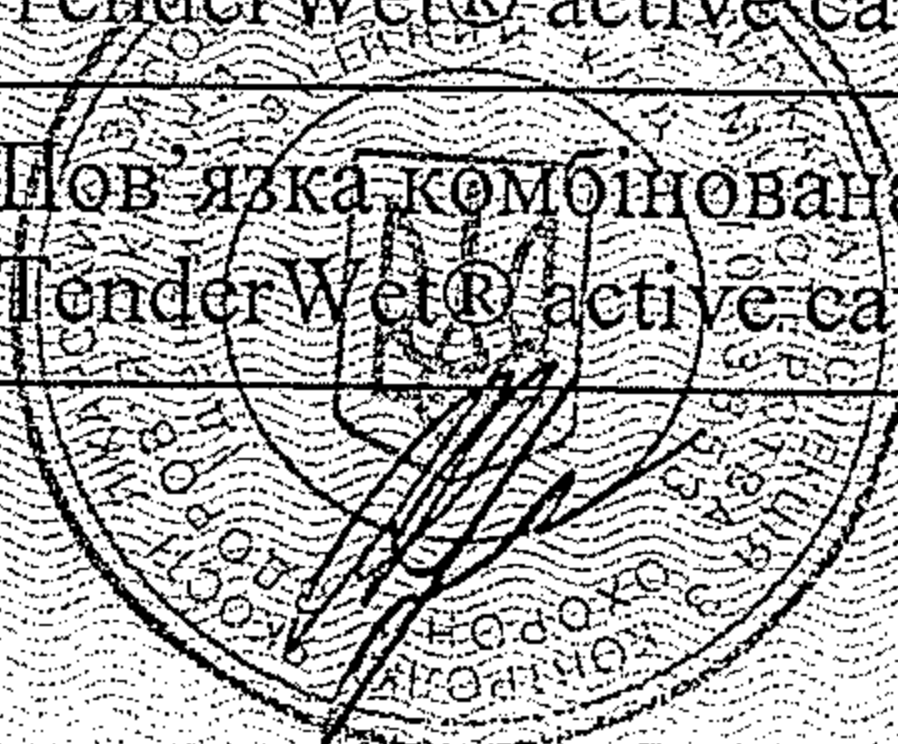

О.О.Кропивний

№ 014863

Микола Кес