

### СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

**Наименование продукта:** Перчатки хирургические латексные припудренные текстурированные стандарт класс одноразовые (размер 7,5) 1314372A

**Стандарты:** Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 10282, EN 455, часть 1, часть 2 и часть 3, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (пар.)	№ лота	Дата произв-ва	Годен до	Дата акта контроля:
7,5	120000	203104555SPZA	07-2020	07-2025	24.07.2020

#### Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр


	Уровень контроля	Результат
<b>Водонепроницаемость</b>	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 1.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 2.5	соответствует

#### Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	270 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	95±5 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты миним	S2, AQL 4.0	0,10мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони миним	S2, AQL 4.0	0,13мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев миним	S2, AQL 4.0	0,13 мм	соответствует

#### Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует

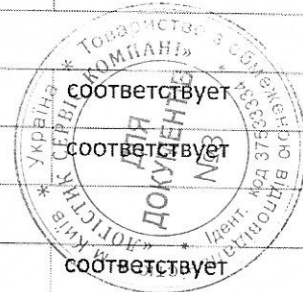

#### Количество порошка

Требование: не более 10 мг/ дм<sup>2</sup>.

Результат: соответствует

**Вывод:** Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам. Vogt Medical Vertrieb GmbH 30.07.2020, Karlsruhe

Вх акт № 2893 от 15.07.20