

5

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

26.08.2022


Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Taiping, Perak, Malaysia

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів			
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin² нестерильні неприпудрені					
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін² (Sempercare Nitrile Skin²) Нітрилові оглядові рукавички		Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:
		XS	2022.08	2022-08 L01 0001	2025.07
		S	2022.08	2022-08 L01 0002	2025.07
		M ✓	2022.08	2022-08 L01 0003	2025.07
		L	2022.08	2022-08 L01 0004	2025.07
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Всього
Кількість рукавичок	280 000	1 520 000	2 614 000	1 400 000	5 454 000

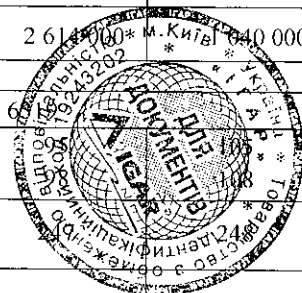

1. Розміри в мм		Згідно з ASTM D 6319			
Ширина долоні: середнє значення, мм	74 78	85 88			
Довжина, середнє значення, мм	247	246			
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.05	0.05	0.05	0.05	
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.07	0.06	0.06	0.06	
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.09	0.08	0.09	0.09	
2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд					
Бар'єрні властивості	G1 AQL 1.5			Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 2.5			Відповідає	
3. Фізичні властивості					Висновок:
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 25 МПа	32.8	29.9	30.6	28.6	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 25 МПа	49.4	33.9	32.3	31.7	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%	560	600	540	540	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400%	460	480	460	460	відповідає
Сила на розрив (після					відповідає

Вх.ам № 0520 від 16.01.2023

Крибалес

випробування з навантаженням) N, середнє значення 6 N	8.6	6.4	6.5	6.4	
Залишки пудри (вимоги: ≤ 2 мг)	0.29	0.32	0.60	0.68	відповідає

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Рукавички хлоровані.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація №4-04/2016 від "13" квітня 2021 року (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.