

### СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

**Наименование продукта:** Перчатки хирургические латексные припудренные текстурированные стандарт класс одноразовые (размер 6,5) 1314370A

**Стандарты:** Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 10282, EN 455, часть 1, часть 2 и часть 3, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произ-ва	Годен до	Дата акта контроля:
6,5	55600	203073712SPZA	03-2019	02-2024	20.03.2019

#### Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр


	Уровень контроля	Результат
<b>Водонепроницаемость</b>	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 1.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 2.5	соответствует

#### Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
	S2, AQL 4.0	Мин 260 мм	соответствует
Длина			
Ширина	S2, AQL 4.0	83±5 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты миним.	S2, AQL 4.0	0,10мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони миним.	S2, AQL 4.0	0,13мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев миним.	S2, AQL 4.0	0,13 мм	соответствует

#### Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует

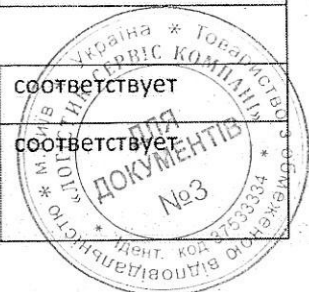

*Вх акт № 1787 вст 05.11.19 [Signature]*

**Количество порошка**

Требование: не более 10 мг/ дм<sup>2</sup>.

Результат: соответствует

**Вывод:** Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 09.04.2019, Карлсруэ

