

ТОВ "Допомога – І"

www.dopomoga1.com

e-mail:

medicare@dopomoga1.com



25
Контактний номер:

Офіс - 380 44 463 77 75

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу:

Пластир медичний фіксуючий "MEDICARE" (в рулоні; на нетканій основі, 5см x 10м)

Виробник:

ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "JIANGSU NANFANG MEDICAL CO.,LTD."

Номер партії:

21101229

Дата виготовлення:

2022.01

Термін придатності:

2026.12

№	Параметр що тестується		Од. виміру	Вимоги	Данні тестування	Фактичний результат
4.1	Зовнішній вигляд		-	Пластир має бути чистим, лицьова частина не містить клею, має бути однорідною, гладкою, без плям, дірок, не повинно бути ділянок без клейкої речовини	-	Відповідає вимогам
4.2	Основні розміри	Довжина	см	1000,0 ±5,0	1001,3	Відповідає вимогам
		Ширина	см	5,0 ±0,05	5,00	Відповідає вимогам
4.3	Вміст клею		г/м ²	≥20г/м ²	43	Відповідає вимогам
4.4	Міцність на відрив		Н/см	≥1,0Н/см	3,5	Відповідає вимогам
4.5	Адгезивна здатність		мм	≤2,5мм	0	Відповідає вимогам

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікації

Номер технічного файлу та декларації відповідності


СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 55-N

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

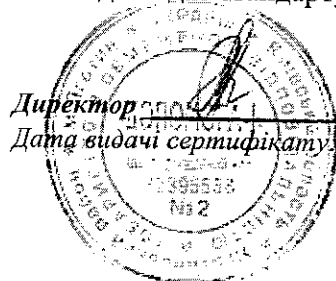

Директор Лариса РОМАНОВА

Дата видачі сертифікату: 27.05.2022

Ф 4.2.3-1 ред_1

Вх. акт 0664

Віг 05.12.2022

Ген